



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

24/12/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20205983

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 30/12/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	IRIGASYON KANULU(METAL UÇLU) 16G	16,00	ADET
2	CONFORMER	15,00	ADET
3	DCR SET	10,00	ADET
4	EYESHIELD	1.000,00	ADET
5	AHMED GLUCOME VALVE	10,00	ADET
6	INFUZYON PORTU 4 MM	10,00	ADET
7	INFUZYON PORTU 6 MM	10,00	ADET
8	SUTURSUZ KAPSUL GERME HALKALARI 10-11 MM	16,00	ADET
9	IRIS RETRAKSIYON KANCASI	5,00	ADET
10	SİLİKON BANT 240	15,00	ADET

TEKLİF NO : 20205983
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : EMEL SÜRER
TEL : 4122408
E-MAIL : emel.surer@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

24/12/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20205983

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

30/12/2020

TARİHİ, SAAT

14:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	RAY	20,00	ADET
12	TREPAN	10,00	ADET
13	DIATERMI	5,00	ADET
14	IOL MANIPULATOR (LESTER)	80,00	ADET
15	NUCLEUS CHOPPER	60,00	ADET
16	NUCLEUS ROTATOR (JAFTE/MALTZMAN)	50,00	ADET
17	IOL MANIPULATOR (JAFTE/MALTZMAN)	20,00	ADET
18	DSPOSABLE BACKFLUSH SOFT TIP 23 G	5,00	ADET
19	TANO (ELMAS TOZLU ILM SÜPÜRÜCÜ)	7,00	ADET
20	FAKO TIP 0.9 MM (45 DERECE)	20,00	ADET

TEKLİF NO : 20205983
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : EMEL SÜRER
TEL : 4122408
E-MAIL : emel.surer@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

24/12/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20205983

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 30/12/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	FAKO SLEEVE	25,00	ADET
----	-------------	-------	------

TEKLİF NO : 20205983
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : EMEL SÜRER
TEL : 4122408
E-MAIL : emel.surer@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/12/2020 10:41:49

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

212.0011.000	IRIGASYON KANULU(METAL UÇLU) 16G	ADET	16
212.0013.000	CONFORMER	ADET	15
212.0015.000	DCR SET	ADET	10
212.0023.000	EYESHIELD	ADET	1000
212.0032.000	AHMED GLUCOME VALVE	ADET	10
212.0034.000	INFUZYON PORTU 4 MM	ADET	10
212.0035.000	INFUZYON PORTU 6 MM	ADET	10
212.0036.000	SUTURSUZ KAPSUL GERME HALKALARI 10-11 MM	ADET	16
212.0037.000	IRIS RETRAKSİYON KANCASI	ADET	5
212.0047.000	SİLİKON BANT 240	ADET	15
212.0056.000	RAY	ADET	20
212.0069.000	TREPAN	ADET	10
212.0081.000	DIATERMI	ADET	5
212.0104.000	IOL MANIPULATOR (LESTER)	ADET	80
212.0105.000	NUCLEUS CHOPPER	ADET	60
212.0106.000	NUCLEUS ROTATOR (JAFTE/MALTZMAN)	ADET	50
212.0107.000	IOL MANIPULATOR (JAFTE/MALTZMAN)	ADET	20
212.0119.000	DSPOSABLE BACKFLUSH SOFT TIP 23 G	ADET	5
212.0139.000	TANO (ELMAS TOZLU ILM SÜPÜRÜCÜ)	ADET	7
212.0143.000	FAKO TIP 0.9 MM (45 DERECE)	ADET	20
212.0145.000	FAKO SLEEVE	ADET	25



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/09/2020 10:55:48

TEKNİK ŞARTNAME

4855 DELİKLİ KONFORMER (212.0013)

1. PMMA maddesinden mamul olmalıdır.
2. Atravmatik ve yüzeyi cilalı olmalıdır.
3. Konjunktivanın görülmesine imkan verecek şekilde katı ve seffaf olmalıdır.
4. Mukus drenajına ve ameliyattan sonra göz damlası uygulamasına imkan verecek şekilde delikli olmalıdır.
5. 20,23 ve 26 cm ebatlarında olmalıdır.
6. Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
8. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
9. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
10. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
11. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
12. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
Gözetmen
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

Prof.Dr.Aylin YAMAN
Gözetmen
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

4893 EYE SHIELD (GÖZ KAPAĞI)-(212.0023.000)

1. Sağ ve sol her iki gözün kapatılmasına uygun olmalıdır.
2. Saydam, delikli ve plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Kenarları keskin olmamalıdır.
4. 7-8cm x 6-7 cm ölçülerinde olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
6. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
9. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
10. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATÇI
S3AA09
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip. No: 1832

TEKNİK ŞARTNAME

6241 AHMED GLOKOM VALF SİLİKON (YETİŞKİN) (212.0032.000)

1. Valf; intraoküler basıncı normal seviyeye indirebilecek, aynı adla anılan valf sistemini içermelidir.
2. Valf; her türlü yüksek basınçlı glokomda özellikle neovasküler glokom, üvetik glokom, konjetinal glokomda ve korneal transplantasyonlarda, transplant ile birlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. Valf; tek aşamalı basit cerrahi müdahale ile implant edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Valf gövdesi; silikon, Drenaj tüpü; silikon, Valf; silikon elastomer membrandan imal edilmiş olmalıdır.
5. Valf ebatları;
 - 5.1. Genişlik : 13,00 mm
 - 5.2. Uzunluk : 16,00 mm
 - 5.3. Tüp uzunluğu : 25,00 mm
 - 5.4. Kalınlık : 0,09 mm
 - 5.5. Yüzey alanı : 184,00 mm²(kare) olmalıdır.
6. Valf; non obstructive valf sistem teknolojisi ile aşırı drenajı engelleyerek ön kamara kollapsını önleyecek venturi-flovalf sistemine sahip olmalıdır.
7. Valf; orjinal ambalajında ve en az 2 yıl miadlı teslim edilmelidir.
8. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
9. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
10. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
11. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
12. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATÇİ
B3A A051
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi


Prof. Dr. Aylin YAKAR
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları
Dip.No:1632

TEKNİK ŞARTNAME


4629 4 MM İNFÜZYON KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (212.0034.000)

1. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
2. 20 G (0.9mm) genişliğinde olmalıdır.
3. İnfüzyon tüpüne bağlanan kısmı dayanıklı ve tek parça olmalıdır.
4. Kanülün metal ucuna ait ağız kısmı 45 derece açılı olmalıdır.
5. Metal uç 4 mm uzunluğunda olmalıdır. (High viscosity injector (Hammer))
6. Esnek tüp 10 cm olmalıdır.
7. Sklere üzerine sabitlenen kısım saydam olmalıdır.
8. Tek tek steril paket içerisinde olmalı ve ürün üzerindeki bilgiler orjinal olmalıdır. Sonradan yapıştırma (stiker v.s.) olmamalıdır.
9. CE belgesine ait olmalıdır.
10. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
11. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
12. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
13. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
14. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
15. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
83AA061
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi



Prof. Dr. Aylin YAMAN
G. EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
G. EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
G. EYLÜL ÜNİVERSİTESİ





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/09/2020 11:00:37

TEKNİK ŞARTNAME

4858 6MM İNFÜZYON PORTU (212.0035.000)

1. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
2. 20G (0.9mm) genişliğinde olmalıdır.
3. İnfüzyon tüpüne bağlanan kısmı dayanıklı ve tek parça yapıda olmalıdır.
4. Kanülün metal ucuna ait ağız kısmı 45 derece açılı olmalıdır.
5. Metal uç 6mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Esnek tüp 10cm olmalıdır.
7. Sklere üzerine sabitlenen kısım saydam olmalıdır.
8. Ürün numunesi ilgili hekimler tarafından denenerek karar verilecektir.
9. Tek tek steril paket içerisinde olmalı ve ürün üzerindeki bilgiler orijinal olmalıdır. Sonradan yapıştırma (stiker vs.) olmamalıdır.
10. CE belgesine sahip olmalıdır.
11. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
12. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
13. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
14. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
15. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
16. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATÇI
SAAAGS1
Göz Hastalıkları Uzmanı
S. EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTAHANESİ

Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip No:1632

TEKNİK ŞARTNAME

4634 SERKLAJ BAND (212.0047)

1. Retina cerrehisinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Tıbbi silikondan üretilmiş olmalıdır.
3. 240 style ve 2,5 mm eninde olmalıdır.
4. İçinde bağlayıcı sleeve olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
7. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
8. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
9. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
10. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
83AA061
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi



Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Gözetmen



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

6542 RETİNAL STRİP / RAY (212.0056)

1. Skleral çökertme yapabilmek için üretilmiş olmalıdır.
2. Solid silikondan imal edilmiş olmalıdır.
3. Ray genişliği 2.5 mm olmalıdır.
4. Kalınlık 1.50 mm olmalıdır.
5. Total taban genişliği 7,50 mm. Normal taban genişliği 6,0 mm olmalıdır.
6. Malzemenin ezilmemesi ve zarar görmemesi için sert özellikli çift blister steril ambalajda olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
8. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
9. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
10. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
11. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
12. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATÇI
83AA061
Göz Hastalıkları Uzmanı
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi



Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip.No:1632

TEKNİK ŞARTNAME

7430 IOL MANİPÜLATÖR (LESTER) (212.0104)

1. Katarakt ameliyatlarında göz içi lensini manipülasyon amacı ile kullanılan kıvrık uçlu manipülatör olmalıdır.
2. Kıvrık kısmı 10 mm 'den itibaren 45° açılı olmalıdır.
3. Uç kısmı lensi ve dokuları zedelemeyecek biçimde düzgün olmalıdır.
4. Tek tek steril paket içerisinde olmalı ve ürün üzerindeki bilgiler orjinal olmalıdır. Sonradan üzerine yapıştırma (sticker) olmamalıdır.
5. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
6. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
9. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
10. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
83AA081
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi




Prof. Dr. Aylin YAMAN
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI
22/09/2020

TEKNİK ŞARTNAME

7296 NUCLEUS CHOPPER (212.0105)

1. Uç kısmından 6 mm uzunlukta 45 derece açılı olmalıdır.
2. Tip kısmı uçtan 1.5 mm mesafede 90 derece açılı, künt ve yuvarlak uçlu olmalıdır.
3. Fako stop-chop tekniğine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
4. Ürün üzerindeki bilgiler üretim yeri çıkışlı (orijinal) olmalıdır. Sonradan yapıştırma (stiker vs.) olmamalıdır.
5. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
6. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir..
9. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK` nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
10. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

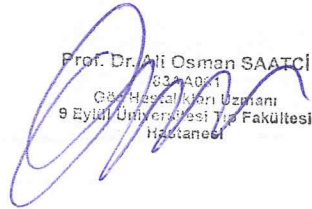
Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi


Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip.No:1632



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

22/09/2020 10:59:39

TEKNİK ŞARTNAME

7431 NUCLEUS ROTATOR (JAFTE/BECHERT) (212.0106)

1. Faköemülsifikasyon sırasında nucleus u döndürmek için kullanıma uygun olmalıdır.
2. 45° açılı, uçtan 9mm. Kıvrılmış olarak tasarlanmış olmalıdır.
3. Uç kısmı lense ve dokuları zedelemeyecek biçimde düzgün olmalıdır.
4. Tek tek steril paket içerisinde olmalı ve ürün üzerindeki bilgiler orjinal olmalıdır. Sonradan üzerine yapıştırma (sticker) olmamalıdır.
5. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
6. Yüklenci firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenci firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
9. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
10. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
82AA051
Göz Hastalıkları Uzmanı
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

Prof. Dr. Aylin YAMAN
EYLÜL GÖZ Hastanesi A.Ş.
EYLÜL 2020

TEKNİK ŞARTNAME

7434 IOL MANİPÜLATÖR (JAFTE/MALTZMAN)(212.0107)

1. Katarakt ameliyatlarında göz içi lensini manipölasyon amacı ile kullanılan ve ucu "Y" biçiminde dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Ucundan 12mm geriye doğru 45° açılı olmalıdır.
3. En az 0.2 mm'lik deliklerden geçebilmelidir.
4. Uç kısmı lensi ve dokuları zedelemeyecek biçimde düzgün olmalıdır.
5. Tek tek steril paket içerisinde olmalı ve ürün üzerindeki bilgiler orjinal olmalıdır. Sonradan üzerine yapıştırma (sticker) olmamalıdır.
6. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
7. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
8. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
9. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
10. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
11. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
83AA05
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip.No:1632



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/09/2020 14:51:07

212.01197
.0191

TEKNİK ŞARTNAME

7376 DISPOSABLE BACKFLUSH SOFT TIP

1. 23 Gauge ve 25 Gauge steril ambalajında tek kullanımlık olmalıdır.
2. Doku hemorajilerinde kullanılmak amaçlı yapılmış olmalıdır.
3. Aspirasyon ve backflush kontrolü doktor tarafından yapılmaya uygun olmalıdır.
4. Hem aktif Hemde pasif aspirasyona uygun tasarlanmış olmalıdır.
5. Silikon uçlu olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
7. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
8. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
9. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
10. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
11. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATÇI
83AA061
Göz Hastalıkları Uzmanı
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip.No.1838

TEKNİK ŞARTNAME

7373 FAKO TİP 0.9 MM (45 DERECE)(212.0143)

1. Hastanemizde bulunan Alcon Infinity model fako cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Tip, plastik tip sıkacağıının içerisinde ve ikiside steril paketlenmiş halde olmalıdır.
3. Cihazın ozil özelliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Tip'in alt kısmında vidalanacak yivlerin bulunması gerekmektedir. 1,1mm lik tiplerler karışmaması ve hasta güvenliğini sağlamak amacıyla, bu yivlerin renkleri farklı olmalıdır.
5. Tip 0.9mm çapında, 45 derece mini flared, ABS özelliği bulunmalı ve bu özellik paket üzerinde yazılı olmalıdır.
6. Tip en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
9. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
10. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
11. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATÇI
83AA061
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi



Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip.No:1833

TEKNİK ŞARTNAME

7422 FAKO SLEEVE VE TEST CHAMBER (212.0145)

1. Hastanemizde bulunan Alcon Infinity fako cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Sleeve paketinde 2 adet sleeve, 1 adet test chamber ve 1 adet irrigasyon aspirasyon sıkacağı olmalıdır.
3. Çift sterilizasyon paketi içinde olmalıdır.
4. 0.9 mm lik tiplere uygun olduğunu belirlemek için mor renkte olmalıdır.
5. Micro Smooth sleeve özelliği olmalıdır.
6. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatli olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
9. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
10. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
11. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
83AA081
Göz Hastalıkları Uzmanı
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastaneleri

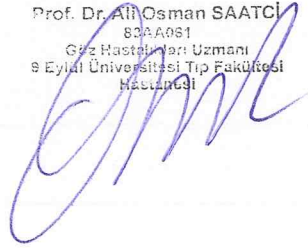

Prof. Dr. Aylin YAMAN
Göz Hastalıkları Uzmanı
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastaneleri





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/09/2020 14:27:12

212.0011

TEKNİK ŞARTNAME

7006 İRRİGASYON KANUL (METAL UÇLU) 16 G

1. 16 G. olmalıdır.
2. Tümü metal olmalıdır.
3. Ürün numunesi ilgili hekimler tarafından kullanılarak karar verilecektir.
4. Ürün üzerindeki bilgiler üretim yeri çıkışı (orijinal) olmalıdır. Sonradan yapıştırma (stiker vs.) olmamalıdır.
5. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
6. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
9. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
10. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATÇI
83AA031
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip.No:1632



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/09/2020 10:57:01

TEKNİK ŞARTNAME

4856 DCR SETİ (212.0015.000)

1. Materyal paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Bikanalikulüer olmalıdır.
3. Düz, paslanmaz çelik probu olmalıdır. (0.80mm / 0.90MM çapında x 45 / 80 mm uzunluğunda)
4. Çift steril ambalaj içinde olmalıdır.
5. Silikon tüp metal probun üzerinden çıkmayacak özellikte olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
7. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
8. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
9. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
10. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
11. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
83AA004
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi


Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.U.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip.No: 004

TEKNİK ŞARTNAME

4845 KAPSÜL GERME HALKASI (RING) (212.0036.000)

1. Ring tek parça ve PMMA yapıda olmalıdır.
2. 10 mm ve 11mm ölçülerinde olmalıdır.
3. Halkanın her ucunda pozisyon delikleri olmalıdır.
4. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
5. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
6. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
7. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
8. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
9. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SA...
83A/061
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi



Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip.No:1632


TEKNİK ŞARTNAME

4853 İRİS RETRAKTÖR KANCASI (212.0037.000)

1. Göz içi operasyonlarında irisi genişletmek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
2. Retraktörler göz içi operasyonlarında irise zarar vermeyen flexible malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. 0.5mm lik insizyondan geçebilmelidir.
4. Dilatasyonun kontrol ve devamı için her bir retractorde bir adet tıpa bulunmalıdır.
5. İçinde en az 4adet olmalıdır.
6. Steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
8. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
9. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
10. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
11. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
12. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATÇI
837 A061
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
21.09.2020



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/09/2020 09:57:48

TEKNİK ŞARTNAME

4841 TREPAN (212.0069.000)

1. Keratoplasti ameliyatlarında alıcı korneadan sağlıklı kornea dokusunun çıkartılması amacıyla kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Vakumlu olmalıdır ve vakumu sayesinde kornea üzerinde sabitlenebilmelidir.
3. Bıçağın kesiciliği mükemmel olmalıdır.
4. 6.0-9.0 mm aralığında seçenekleri olmalıdır.
5. Trepan kutusunda keratoplasti için üretilmiş 3/8 mm daire iğneli, 10/0 monofilaman suture olmalıdır.
6. Korneaya temas eden kısmında en az 16 adet işaretleyici olmalıdır.
7. Beraberinde steril işaretleme kalemi verilmelidir.
8. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası ve UBB kodu belirtilmiş olmalıdır.
9. Son kullanma tarihi teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl (24 ay) olmalıdır.
10. Onaylı ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte sunulmalı ve onaylı ürün numarası ihale sıra numarası ile mutlaka kalem bazında ilişkilendirilmelidir.
11. Onaylı ürün (barkod) numaraları, EAN-13 veya HIBC formatında ürün ambalajı üzerinde yer almalıdır.
12. Yüklenici firma, ürüne ait marka adı, onaylı ürün (barkod) numarası, varsa model ve firmaya ait malzeme kodu bilgilerini ürün tesliminde yazılı olarak sunmalıdır.
13. Yüklenici firma, vereceği ürün ölçülerini kliniğin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak listeye göre belirleyecek, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçülerdeki ürünleri istenilen ürünler ile değiştirmeyi kabul edecektir.
14. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
15. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
16. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
17. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATÇI
83AA067
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

Prof. Dr. Aylin YAMAN
E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
02.09.2020



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

22/09/2020 11:32:36

TEKNİK ŞARTNAME

212.001

8558 25G ENDOKOTER PROBU

1. Paket; içinde constellation cihazına bağlanabilen disposable 25g koter olmalıdır.
2. 25G straight probu sayesinde 23g ve 25g tekniklerde koterizasyon işlemini yapabilmelidir.
3. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzeme , özel olarak imal edilmiş, ambalajı içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
4. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
5. Paket nereden güvenle açılacağını gösterecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır.
6. Hastane ihtiyacına göre 27G ile değişim talep edebilir.
7. Paket cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır. Orijinal ürün dışında teklif veren firma , cihazın malzemeden kaynaklanan arızası durumunda cihaz yetkili servisine ücreti mukabili tamir ettireceğini belirten noter tasdikli belge verecektir. Ayrıca cihazın tamiri süresince kullanılmak üzere hastanemize aynı cihazı bırakacaktır.
8. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
9. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
10. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
11. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
12. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
83AA051
Göz Hastalıkları Uzmanı
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

Prof. Dr. Aylin YAMAN
Göz Hastalıkları Uzmanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/09/2020 11:25:38

TEKNİK ŞARTNAME

6895 TANO (EXTENDIBLE DIAMOND DUSTED SWEEPER)212.0139.000

1. Tek kullanımlık olmalıdır, gövde elden kaymayı engellemek amacı ile pürüzlü yapıda olmalıdır.
2. Paket üstünde kod numarası ,CE işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır.
3. 25 Gauge olmalıdır.
4. Alet ucu elmas tozu ile kaplanmış olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün steril çift blaster ambalaj içinde, paketin nereden açılacağına dair ön ve arka yüzünde işaretler olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
7. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
8. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
9. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
10. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
11. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Prof. Dr. Ali Osman SAATCI
S/AA001
Göz Hastalıkları Uzmanı
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi

Prof. Dr. Aylin YAMAN
D.E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.
Dip.No:1632