



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

16/08/2019 10:06:10

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194910

16/08/2019 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

21/08/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İSLETME MÜDÜRÜ V

ALIM KONUSU MALZEMELER


MİKTAR

1	ALUMİNYUM MERDİVEN (KATLANABİLİR)	2,00	ADET
---	-----------------------------------	------	------

Teklif No : 20194910
Not : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/07/2019 14:43:35

TEKNİK ŞARTNAME

8785 ALİMÜNYUM MERDİVEN (ÇİFT TARAFLI - A TİPİ AYAKLI - BEŞ BASAMAKLI)

1. KONU: Bu teknik şartname; DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı olan Temizlik işlerinde kullanılmak üzere "ALİMÜNYUM MERDİVEN ÇİFT TARAFLI BEŞ BASAMAKLI (A TİPİ)" ile ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER :
 - 2.1. Naturel eloksallı alüminyum profilden imal edilmiş olmalıdır.
 - 2.2. A tipi ayaklı, çift taraflı basamaklı, katlanabilir olmalıdır.En fazla 150 kg taşıma kapasitesi olmalıdır.
 - 2.3. Ayakların fazla açılmasını önleyen 2 taraflı metal makaslı güvenlik sistemi olmalıdır.
 - 2.4. Merdiven basamakları kaymayı engelleyici, çentikli, perforeli veya kabartma dekorlu olmalıdır.
 - 2.5. Basamaklar yaklaşık 75-100 mm derinliğinde olmalıdır.
 - 2.6. Merdiven kapalı boyu 120-125 cm, açıldığında boyu 110-120 cm olmalıdır.
 - 2.7. Basamak aralıkları 20 - 25 cm olmalıdır.
 - 2.8. Merdiven ayaklarında sert plastik (PVC) takoz olmalıdır. Bu takozlar çıkmayacak şekilde takılmış olmalıdır.
 - 2.9. Merdivenin hiçbir yerinde keskin kenar ve çapak olmamalıdır.
 - 2.10. Karşılıklı olarak iki kişi merdiveni kullanabilmelidir.
 - 2.11. Beş basamaklı olmalı ve basamaklar dahil en üst platformda kullanıcının malzemelerini koyacağı geniş platform olmalıdır.
 - 2.12. Merdiven genişliği 47-53 cm olmalıdır.
3. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
 - 3.1. Firmalar teklifleri ile birlikte numuneleri getireceklerdir.Tekliflerin kabulü ve uygunluğuna getirilen numunelerle, ilgili birimler ve teknik hizmetler müdürlüğünce şartnamaya uygunluğu incelendikten sonra karar verilecektir.
 - 3.2. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
 - 3.3. Üretici firma, ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 belgelerine sahip olmalıdır.Merdiven EN 131 standartlarına uygun olmalıdır.
 - 3.4. Üretici ve/veya temsilci firma " Garanti Belgesi "ni idareye sunmak zorundadır.
 - 3.5. Çağsan 5 basamaklı çift çıkışlı " OL5-LFD115AL" modeli referans modeldir.
 - 3.6. Yukarıda belirtilen marka-model örnek olarak verilmiş olup, firmalar benzer özelliklerde teknik şartnamenin ilgili maddelere uymak kaydıyla farklı marka ve maddelerde teklif edebilirler.
 - 3.7. Sistemin tüm parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda cihaz; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim edilmeyecektir.
4. TEKNİK SERVİS,GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI:
 - 4.1. Merdiven üretim hatalarına karşı, parça dâhil en az 2 yıl tam garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.
 - 4.2. Firma, ürüne yapılan bakım ve onarımlar için servis raporu düzenleyecek, bir kopyasını sistem sorumlusuna teslim edecektir.

Dğr. Gör. M. Yucak KORSACILAR



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/07/2019 14:43:35

4.3. Satıcı ve/veya temsilci firma teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgelemelidir.

5. MONTAJ:


5.1. Merdivenler montajı tamamlanmış, tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır durumda depoya teslim edilecektir.

5.2. Nakliye, kullanıcı birime taşıma ve yerleştirme ihaleyi kazanan firmaya aittir.

6. KABUL VE MUAYENE:

6.1. Teklif edilen uygunluğu için ve/veya İhale/Satın alma sözleşmesi sonrası Ürünlerin kabul ve muayeneleri hastane tarafından belirlenecek, kullanıcı birimin de olduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin ve belgelerin uygunluğuna bakılacaktır. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.

6.2. İhalede teklif edilen ürünün yeterliliği ve/veya İhale/Satın alma sözleşmesi sonrası Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

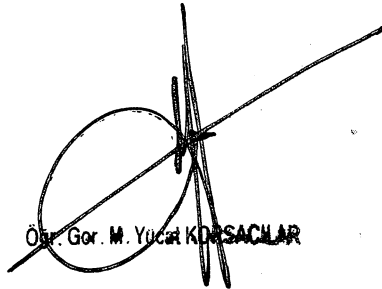

Öğr. Gör. M. Yücel KÖKSACILAR