



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

06/12/2022 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20228070

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/12/2022 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SİMİT KAFA PEDI YENİDOĞAN (SİLİKON , JEL YAPIDA)	5,00	ADET
2	SİMİT KAFA PEDI PEDIATRİK (SİLİKON , JEL YAPIDA)	5,00	ADET
3	SİMİT KAFA PEDI ERİSKİN (SİLİKON , JEL YAPIDA)	20,00	ADET

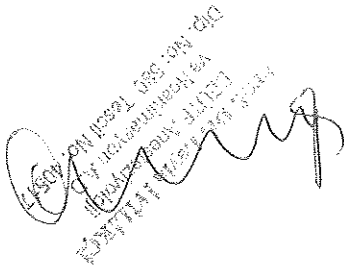
TEKLİF NO : 20228070
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

ANTI-BASINÇ PED VE POZİSYONERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Jel Pedler özellikle uzun sürebilen ameliyatlarda ve post-op şartlarında basınçdan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmaları (dekübit yaralar) ile hipotansiyon riskini önlemelidir.
- 2- Pedler vücuttaki dekübit oluşumunu engellemeli ve bu maksatla aşağıdaki kriterlere uygunluğu bilimsel yayınlardaki verilerle belgelenmelidir :
 - 2a) Pedlerin kullanımından enaz 1 saat sonra bile vücut ısısını artırmamalıdır.
 - 2b) Pedlerin kullanımından enaz 1 saat sonra bile 50 kcal/m²/h ($\pm$ %10) ısı geçirgenliğine sahip olmalıdır.
 - 2c) Pedlerin kullanımından enaz 1 saat sonra bile vücuttaki bağıl nem oranını maksimum %15 ($\pm$ 5) artırmalıdır.
- 3- Doku hasarını en aza indirmesi için basıya karşı direnç göstermemeli ve bunun için pedlerin basınç altında kendi kalınlığının %25'i kadar incilmesi halinde bile gösterdiği karşı direnç inç² başına maksimum 0.5 libre ($\pm$ 0.2 libre) olmalı ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
- 4- Pedlerin kalınlığının basınç altında en az %50 inceltiilerek, en z 1 tam gün ($\pm$ 2 saat) tutulması halinde bile serbest kaldığında tamamen eski haline dönebilmeli ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
- 5- Pedlerin içindeki polimer malzeme yapılan testlerde 10 katına kadar uzatılsa bile yine eski haline dönebilmeli ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
- 6- Pedler "yumuşak doku eşdeğer malzemesi" olarak bilinen suyun ışınları emme oranına kıyasla maksimum $\pm$ %10 değerlerde emme oranına sahip "doku-benzeri" bir maddeden yapıldığı bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
- 7- Silikon, Vinil, Hava, Köpük, Sünger ve Likit esaslı vb. akma yapabilen, zamanla deforme olan alerjik maddelerden mamul olmamalıdır
- 8- Pedlerin alev-almadığı; aleve maruz kalsa bile 2 sn içinde ($\pm$ 2 sn) kendi-kendine sönmölenen bir yapıda olduğu bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
- 9- Yukarıda 2,3,4,5,6 ve 8. Maddelerde istenen fiziki kriterlerle ilgili olarak firmaların beyanı/firma teyidi kabul edilmeyecek; üniversite ve enstitü test raporları teklif ekinde verilecektir. Yabancı dildeki belge ve bilimsel yayınlar ise yeminli tercüman ve noter-onaylı olarak verilecektir.
- 10- Jel pedler dış ortam ve bazı ameliyathane koşullarına dayanıklı olmalı; -17 C ile +46 C gibi bir aralıkta deforme olmadan görev yapmaya imkan vermelidir.
- 11- Reusable olmalıdır ve kolayca temizliği yapılabilmelidir. Ürünlerin altında CE işareti, 2 yıl garanti takibi için lot numarası ve imalatçı firma bilgileri ürün yüzeyine imalatçı tarafından çıkmayacak-silinmeyecek bir teknikle basılmış olmalıdır.


Dip. No: 538 Tescil No: 52745


Prof. Dr. Ali Necati GÖKMEN
D.E.Ü. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji
ve Reanimasyon ABD
Dip. No: 538 Tescil No: 52745