



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20261297

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/03/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KIST HIDATİK	816,00	TEST
2	ANTI HUMAN IGG (GAMMA-CHAIN SPESİFİK)-FITC ANTİBODY (0,5 MILİLİTRE 'LİK)	1,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20261297

NOT : PARAZİTOLOJİ

İLGİLİ KİŞİ : ERİNÇ ERGEN

TEL :

E-MAIL : erinc.ergen@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

142.0141.000	KIST HIDATİK	TEST	816
152.0359.000	ANTI HUMAN IGG (GAMMA-CHAIN SPESIFIC)-FITC ANTIBODY(0,5 MILILITRE 'LIK)	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

ANTI-HUMAN IgG (Gamma- chain spesific)-FITC ANTIBODY


TEKNİK ŞARTNAMESİ

152.0359.000

KİM 8882

1. İnsan IgG antikorlarının gamma ağır zincirine karşı üretilmiş anti-antikordur
2. Keçide üretilmiş ve poliklonal özellikte olmalıdır
3. Fluorescein isothiocyanate (FITC) ile işaretlenmiş olmalıdır
4. İndirekt floresan antikor tekniğinde (IFAT) kullanıma uygun olmalıdır
5. Phosphate buffered saline (pH 7.4) içinde süspanse edilmiş olmalıdır ve buffer solüsyon 1% bovine serum albumin ve 15 mM sodium azide içermelidir
6. Solüsyon halinde ve 0,5 ml' lik ambalajlarda temin edilmelidir
7. Saklama koşullar- 2-8 °C arasında olmalıdır

Prof. Dr. Soykan ÖZKOÇ
Tıbbi Parazitoloji Uzmanı
Dipl. No: 9708
Dipl.Tes.No: 63920

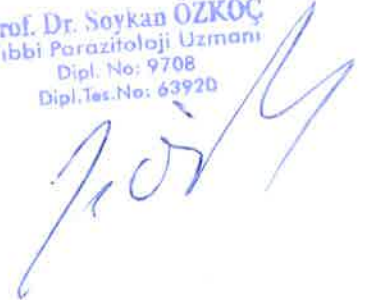

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR 2026 YILI
PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI İHALESİ
TEKNİK ŞARTNAMESLERİ**

1. Bu teknik şartname 4 maddeden ve 1 kalemde oluşmaktadır.
2. Her kalem için ayrı teklif verilebilir.
3. Bu teknik şartname ile aşağıda adları ve miktarları yazılı testlerin satın alınması istenmektedir.

SIRA NO	TEST ADI	MİKTAR	BİRİM
1	KİST HİDATİK İHA KİTİ	816	test

4. KİST HİDATİK İHA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 4.1. Echinococcus granulosus (kistik ekinokokkozis) serolojik tanısında kullanılacak indirekt hemagglütinasyon testi olmalıdır.
- 4.2. Bir kutu kit içeriğinde en az 2 ml sensitize eritrosit (Echinococcus granulosus antijeni ile duyarlaştırılmış koyun eritrositleri) özel metal uçlu damlalığı ile birlikte bulunmalıdır.
- 4.3. Bir kutu kit içeriğinde en az 1 ml unsensitize eritrosit özel metal uçlu damlalığı ile birlikte bulunmalıdır.
- 4.4. Bir kutu kit içeriğinde Ph: 7.2 olan en az 50 ml fosfat tampon bulunmalıdır.
- 4.5. Bir kutu kit içeriğinde en az 0,2 ml pozitif kontrol ve 0,2 ml negatif kontrol bulunmalıdır.
- 4.6. Bir kutu kit içeriğinde 2 ml hayvan kökenli adsorbant bulunmalıdır.
- 4.7. Bir kutu kit içeriğinde 2 adet U tabanlı 96 çukurlu sulandırım plağı bulunmalıdır.
- 4.8. Testin saklama koşulları 2-8 °C olmalı ve ulaşım üretici firmadan soğuk zincir şartlarında sağlanmalıdır.
- 4.9. Son kullanım tarihi laboratuara teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- 4.10. Kitin kullanım süresi bitmeden çalışmadığı tespit edilmişse firma ücret talep etmeden yeni kitle değiştirmelidir.
- 4.11. Üretici firma, ISO 9000 serisi belgelerden birisine ve ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- 4.12. Teklif edilen kitler ihale günü ve saatinden itibaren 7 gün (168 saat) içinde Merkez laboratuvarının belirleyeceği koşullar çerçevesinde denenmesi için hazırlanacak ve laboratuvar sorumluları tarafından denenecektir. En az 10 test denenmesi için uygun miktar temin edilmelidir. Merkez laboratuvarı tarafından daha önce kullanılmış ve/veya denenmiş kitlerden tekrar demonstrasyon istenmeyebilir. Demonstrasyonu yapılmayan kitler ile ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Prof. Dr. Soykan Özkoc

Doç. Dr. Cem Ergon